

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI/RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025

PORTAL: BLL

DATA: 30/09/2025 AS 09H

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços da licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

### **PROPOSTA COMERCIAL**

| ITEM/<br>LOTE | DESCRIPTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARCA/MODELO                                                    | QTD               | R\$ UNIT<br>PROPOSTO | R\$ TT<br>PROPOSTO |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 43            | <p>Integrador Químico Clean Test (Tipo 05)<br/>Integrador Químico para Monitoramento de Processos de Esterilização a Vapor.<br/>Proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados. Excelente estabilidade indicadora antes e depois da exposição.<br/>Monitoramento de tempo, temperatura e qualidade de vapor em relação a curva de morte do indicador biológico.<br/>Os parâmetros críticos de esterilização são:<br/>☐ 121 °C - 16,5 min - Vapor Saturado<br/>☐ 128 °C - 9 min - Vapor Saturado<br/>☐ 134 °C - 3,5 min - Vapor Saturado<br/>Esta condição é calibrada com o tempo de morte de esporos Geobacillus stearothermophilus, calculado em um BIER (Biological Indicator Evaluator Resistometer), conforme estipulado em ISO 11140 para um Indicador químico Tipo 5.<br/>Classificação: Tipo 5.<br/>As características do integrador Clean Test atendem os requisitos contidos em ISO 11140: 2014.</p> | <p>CLEAN P/<br/>CLEAN TEST<br/>REF 1260<br/>PCT C/100 TIRAS</p> | <p>10<br/>UND</p> | <p>R\$ 38,75</p>     | <p>R\$ 387,50</p>  |

R\$ 387,50

**PMI Brasil Importadora e Exportadora de Produtos para Saúde Ltda – Predilife®**

CNPJ 41.932.099/0001-47 I.E. 261075128

ESCRITÓRIO I: Rua Capri, 318 – Sala 01 – Pagani II – Palhoça – SC – Brasil – CEP 88.132-229

ESCRITÓRIO II: Est. Geral Faz. do Sacramento I, SNº - Sala 01 – Águas Mornas – SC – Brasil – CEP 88.150-000

Fone: +55 (48) 2132-2358 / (48) 99145-2974

website: [www.pmibrasilmed.com.br](http://www.pmibrasilmed.com.br)

mailbox: [contato@pmibrasilmed.com.br](mailto:contato@pmibrasilmed.com.br)



**R\$ 387,50 TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.**

**PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO DE EMPENHO E/OU ORDEM DE COMPRA.**

**PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 (trinta) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.**

### **DECLARAÇÕES DE PROPOSTA**

Declaramos expressamente que temos pleno conhecimento dos termos do EDITAL em referência e que os aceitamos integralmente;

Declaramos expressamente que atendemos a todos os requisitos e critérios para a habilitação e que apresentamos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em conformidade com o solicitado no EDITAL em referência;

Declaramos, que os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ora apresentados são completos, verdadeiros e corretos;

Declaramos que foram considerados no cálculo dos valores propostos dos itens acima todos os encargos, tributos, custos e despesas necessárias à execução do CONTRATO, conforme elementos do EDITAL;

Assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização de todo o OBJETO da CONCESSÃO, em conformidade com o EDITAL e seus ANEXOS, bem como com a legislação aplicável;

A PROPOSTA COMERCIAL ora apresentada foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra participante potencial ou de fato do processo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Declaramos a garantia integral e assistência técnica gratuita para os Equipamentos, de no mínimo de 12 (doze) meses e 03 (tres) meses para acessórios que apresentem problema de fábrica, contados a partir da data de seu recebimento.

Declaramos para os devidos fins, que somos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

### **DECLARAR QUE:**

As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

### **RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE ATA/CONTRATO DE FORNECIMENTO**

RESPONSÁVEL: Camila Bornhausen do Santos

CPF nº 072.934.339-13 – RG nº 3436258

Endereço: Rua Capri II, nº 318, sala 01, Pagani II, Palhoça/SC, CEP nº 88132-229

CONTATO: (48) 2132-2358; 9 9145-2974 (whats) 9 9119-2617 (Aline Silva)

E-MAIL: [contato@pmibrasilmed.com.br](mailto:contato@pmibrasilmed.com.br); [comercial@pmibrasilmed.com.br](mailto:comercial@pmibrasilmed.com.br);

### **RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA ATA/CONTRATO**

Nomeamos e constituímos o senhor(a) Aline Priscila Laurentino da Silva, portador(a) do CPF/MF sob n.º 057241344-03 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato**, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato

### **DADOS BANCÁRIOS**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2383-3

C/C: 51592-2

CHAVE PIX: 41932099000147

Águas Mornas, 30 de setembro de 2025.

CAMILA  
BORNHAUSE  
N DOS  
SANTOS:072-  
93433913

Assinado de forma  
digital por CAMILA  
BORNHAUSEN DOS  
SANTOS:07293433913  
Dados: 2025.09.30  
11:25:59 -03'00'

**PMI Brasil Importadora e Exportadora de Produtos para Saúde Ltda – Predilife®**

CNPJ 41.932.099/0001-47 I.E. 261075128

ESCRITÓRIO I: Rua Capri, 318 – Sala 01 – Pagani II – Palhoça – SC – Brasil – CEP 88.132-229

ESCRITÓRIO II: Est. Geral Faz. do Sacramento I, SNº - Sala 01 – Águas Mornas – SC – Brasil – CEP 88.150-000

Fone: +55 (48) 2132-2358 / (48) 99145-2974

website: [www.pmibrasilmed.com.br](http://www.pmibrasilmed.com.br)

mailbox: [contato@pmibrasilmed.com.br](mailto:contato@pmibrasilmed.com.br)

## Integrador Químico Clean Test (Tipo 05)

250 und Ref: 1261 / 100 und Ref: 1260 / 50 und Ref: 1259 / 25 und Ref: 1258

Integrador Químico para Monitoramento de Processos de Esterilização a Vapor. Proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados. Excelente estabilidade indicadora antes e depois da exposição. Monitoramento de tempo, temperatura e qualidade de vapor em relação a curva de morte do indicador biológico.

Os parâmetros críticos de esterilização são:

- 121 °C - 16,5 min - Vapor Saturado
- 128 °C - 9 min - Vapor Saturado
- 134 °C - 3,5 min - Vapor Saturado

Esta condição é calibrada com o tempo de morte de esporos *Geobacillus stearothermophilus*, calculado em um BIER (*Biological Indicator Evaluator Resistometer*), conforme estipulado em ISO 11140 para um Indicador químico Tipo 5.

**Classificação:** Tipo 5.

As características do integrador Clean Test atendem os requisitos contidos em ISO 11140: 2014.

### Instrução de Uso

1. Destaque uma unidade de integrador da cartela sem remove-lo do *liner* (papel base do autoadesivo). Coloque o Integrador na embalagem a esterilizar.
2. Execute o ciclo de esterilização.
3. Avalie a mudança de cor, a área que inicialmente é rosa, agora deve ser igual ou mais escura que a cor de referência presente no produto.
4. Caso não ocorra a mudança de cor adequada conforme apresentado no gabarito para um indicador processado e aprovado, investigue o processo e os demais indicadores químicos que monitoram o esterilizador, bem como o teste biológico. Todo material deve ser esterilizado novamente com nova tira de integrador.
5. Documente os resultados removendo o *liner* do integrador e adesive no local de registro. O local de registro deve ser um ambiente protegido de luz e de alta umidade.


**Medidas:** 75 mm / 19 mm.

**Pacote:** 250; 100; 50 e 25 unidades.

**Responsável Técnico:** Daniel Davi Gruchinski. CRQ IX 09203188


**O produto é Lead Free (livre de chumbo).**

### Armazenagem:


|                                                                                     |                                          |                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Temperatura: 15 °C a 30 °C.              |  | Umidade relativa: 35 % a 60 %.                                              |
|  | Mantenha em local seco, sem condensação. |  | Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc. |

Isento de registro/cadastro conforme instrução normativa nº 2 de 31 de maio de 2011.


## GABARITO

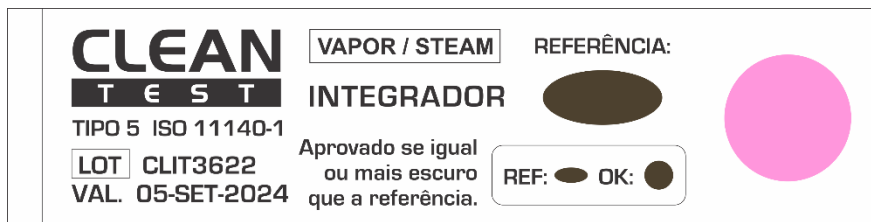


**NÃO PROCESSADO**  
Produto apresentando um padrão de cor inicial rosa.

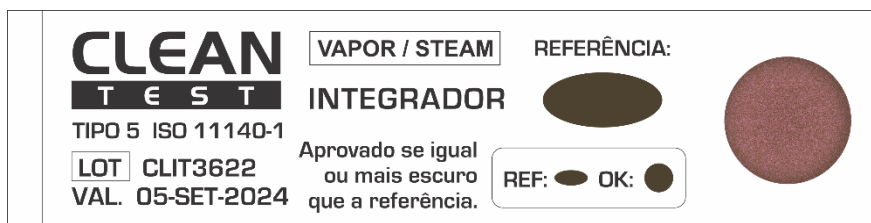

**PROCESSADO E FALHO**  
Coloração mais clara que a cor de referência, parâmetros críticos do processo não alcançados.

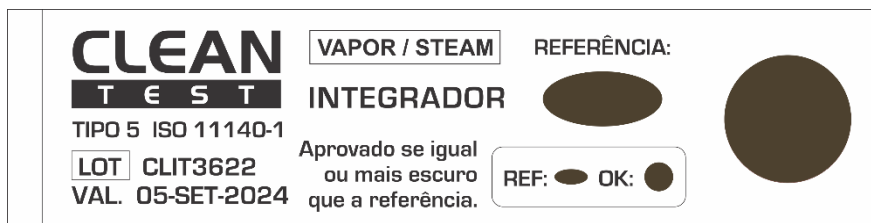

**PROCESSADO E APROVADO**  
Coloração igual a cor de referência, parâmetros críticos do processo alcançados.

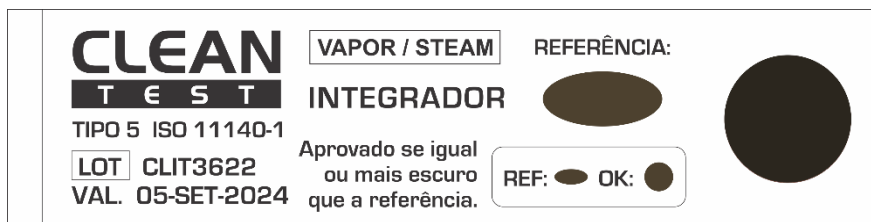

**PROCESSADO E APROVADO**  
Coloração mais escura que a cor de referência, parâmetros críticos do processo alcançados e superados.  
Comumente conhecido como ciclo estendido.

Obs: As cores mostradas são representações das cores iniciais e de sinal da tinta impressa, mas podem variar em relação ao uso real. Cor irreversível quando armazenado em conformidade com os critérios de armazenagem para o produto.



## Caixa Postal



DE: **GEVIT**  
ASSUNTO: **Resposta ao questionamento sobre enquadramento sanitário de INDICADORES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS**

ENVIADA EM: 13/06/2016 16:31:18



Prezados,

Em resposta ao vosso questionamento sobre o enquadramento sanitário de **INDICADORES BIOLÓGICOS E INDICADORES QUÍMICOS** que têm finalidade de controle de ciclos de esterilização informamos:

Os referidos produtos não são considerados produtos para saúde e **não são passíveis de regularização (cadastro ou registro) junto a ANVISA.**

Atenciosamente,

GERÊNCIA DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO *IN VITRO*

# Certificado de Registro

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - ISO 9001:2015

Certificamos que:

Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.-EPP  
Rua Maria Olímpia Jardim, 736  
Jardim Izabel  
Campo Mourão  
Paraná  
87309-185  
Brasil

Possui o Certificado Número:

**FM 505826**

e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2015 para o escopo à seguir:

Desenvolvimento, produção e comercialização de indicadores biológicos para o monitoramento de processos de esterilização no segmento médico, odontológico e estético.

Assina pelo BSI:

  
Carlos Pitanga, Chief Operating Officer Assurance – Americas

Data de Registro Original: 2006-06-09

Data da Última Revisão 2021-05-06

Data efetiva: 2021-05-12

Data de validade: 2024-05-11

Página: 1 de 1



...making excellence a habit.™